



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludDirección General  
de Operaciones  
en Salud

169

F. Elaboración  
Agosto 2020Versión  
1.0

FICHA TÉCNICA	
FAMILIA	MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INCLUIDO LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE
DESCRIPCION FUNCIONAL	Mueble de acero inoxidable rodable diseñado para el traslado de dos lavatorios de acero inoxidable, usado para el traslado de los utensilios necesarios para el baño en cama de pacientes.
A. PARTES Y ACCESORIOS	A01 Una (01) estructura rodante.
	A02 Dos (02) lavatorios.
B. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	B01 Fabricado íntegramente con acero inoxidable AISI 304-2B.
	B02 Estructura rodante fabricada con arcos y travesaños de tubos de acero de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo. Con soporte inferior para mejorar la estabilidad. Con barandas superiores paralelas, con aros para soportar dos lavatorios desmontables, con cuatro patas rematadas en conexión para garruchas.
	B03 Aros tubulares de acero, de 19 mm de diámetro y 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, colocados en la parte superior a fin de sostener dos lavatorios. El borde de cada aro lleva protector de jébe para evitar el ruido.
	B04 Lavatorio de una sola estructura fabricado con plancha de acero de 1.0 mm de espesor como mínimo, con bordes redondeados, sin costuras ni remaches. Con diámetro exterior de 340 mm o más y diámetro interior de 290 mm o más, altura de 70 mm aproximadamente.
	B05 Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con rueda de nylon de 50 mm (2") de diámetro, con eje roscado. Dos de ellas con freno.
	B06 Todas las uniones soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o similar de tecnología superior.
	B07 Dimensiones con tolerancia máxima de +/- 1 % Largo total: 700 mm. Ancho total: 340 mm. Altura total: 860 mm.
C. NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)	C01 Hoja de Especificaciones o Certificado de Calidad del Acero Inoxidable AISI-304 otorgado por el fabricante.
D. CONTROL DE CALIDAD (OBLIGATORIO AL PRODUCTO TERMINADO)*	Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de:
	D01 NTP 260.049:2008 MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso institucional. Métodos de ensayo para la determinación de resistencia, durabilidad y estabilidad. Resistencia a la humedad.

\*Al Postor ganador de la Buena-Pro







268



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Equipamiento y Mantenimiento

MOBILIARIO CLÍNICO


DESCRIPCIÓN:

PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INCLUIDO LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE


FECHA: AGOSTO DEL 2020

CÓDIGO: M - 116


DIBUJO: EAJMR

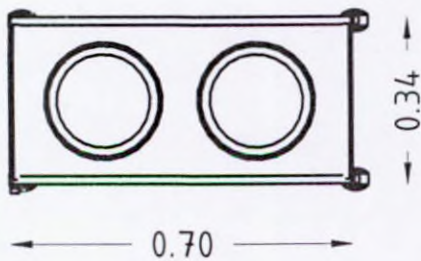

PLANTA

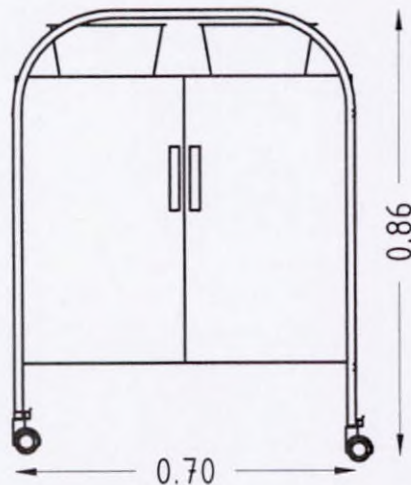

FRONTAL

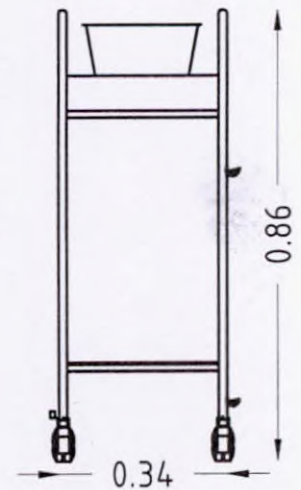

PERFIL